


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	1997年	管理番号	P008241
型式	SV-50/40	測定者	金子晶生	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

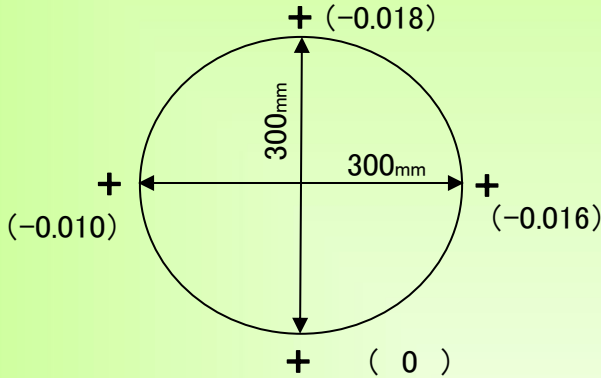

主軸振れ



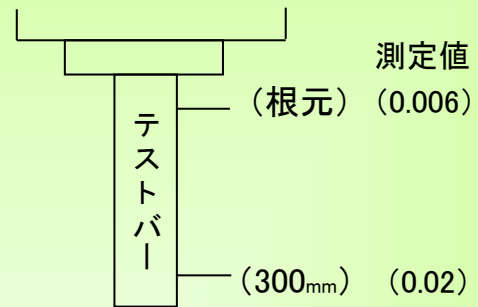


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

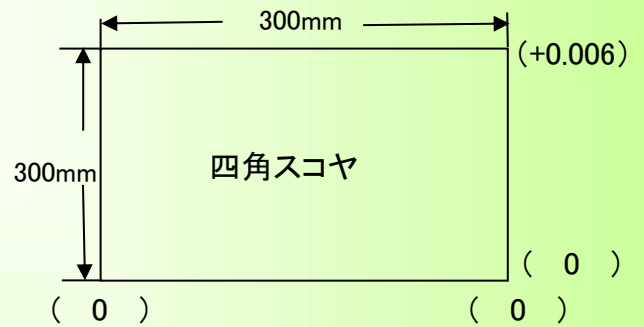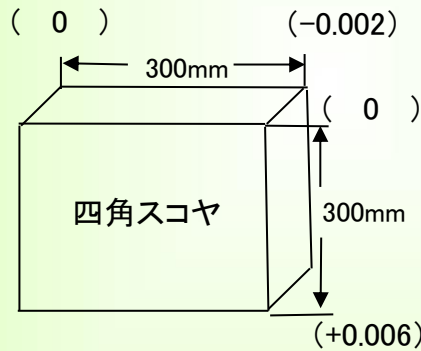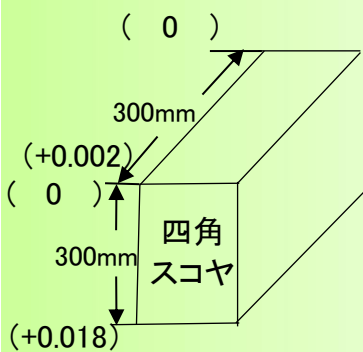

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

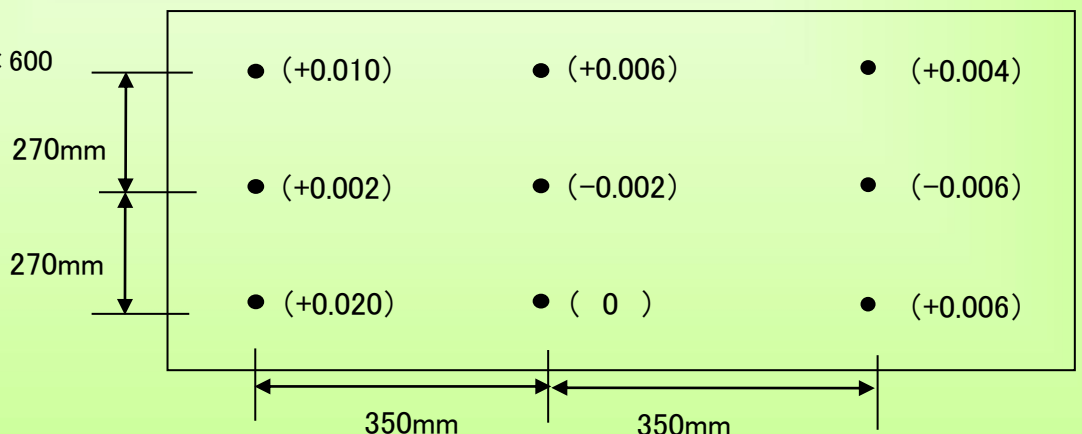

2023/6/29