


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2002	管理番号	P008270
型式	MCH-600	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

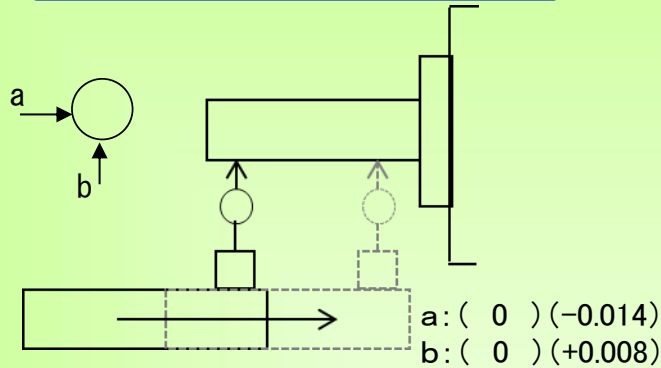

主軸振れ



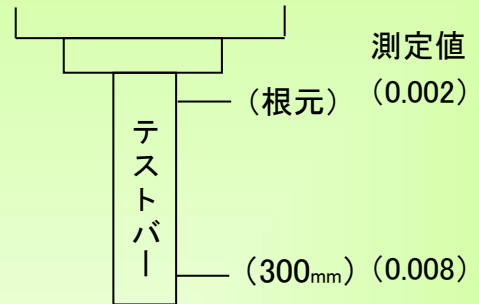


直角度

【XY】 測定値 (0.014)

【ZY】 測定値 (0.008)


【ZX】 測定値 (0.020)

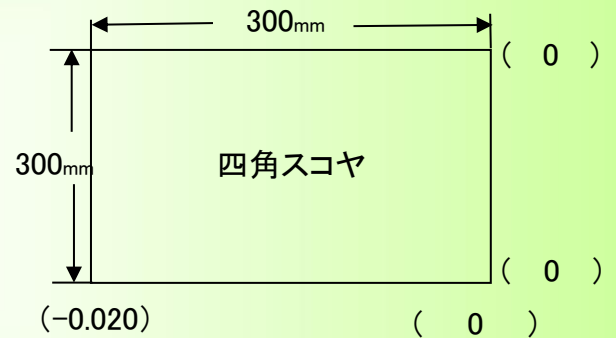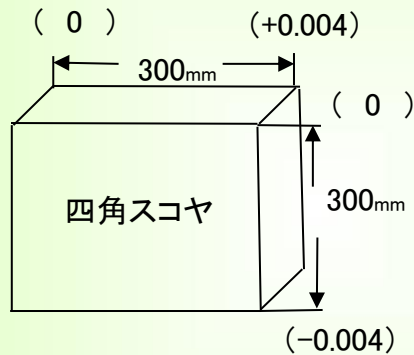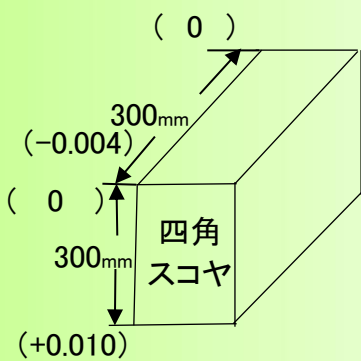

上面精度

テーブルサイズ: 630角

()パレット1
[]パレット2

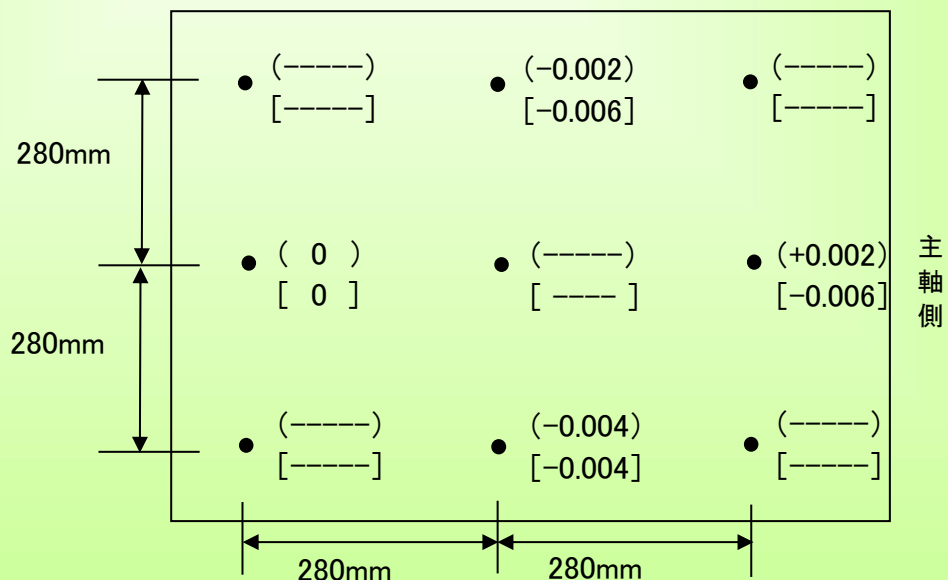

2023/8/30