


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2008	管理番号	P008409
型式	V33i	測定者	金子・立川	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

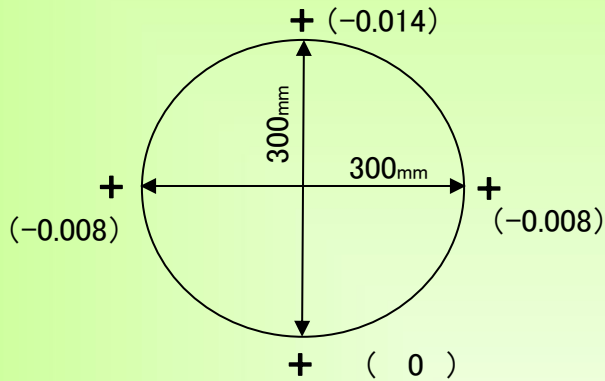

主軸振れ



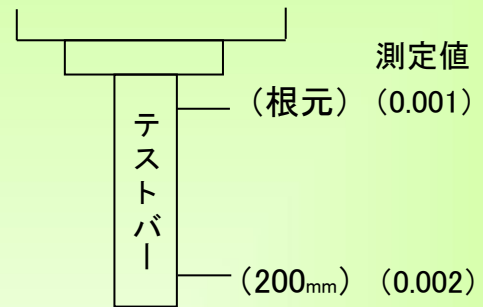


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

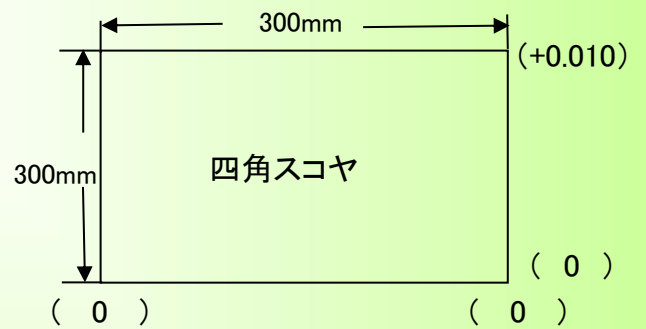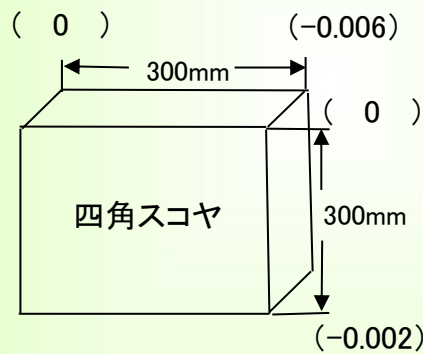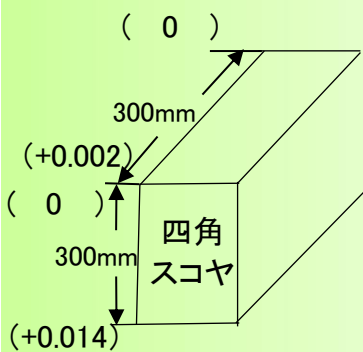

上面精度

※テーブルサイズ 750×450

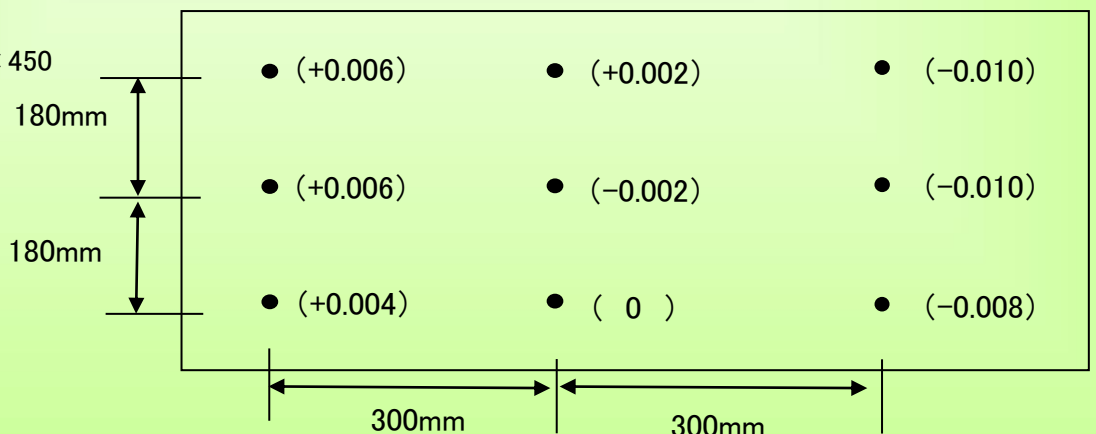

2023/11/15