


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	1997.12	管理番号	P008255
型式	SV-500/40	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

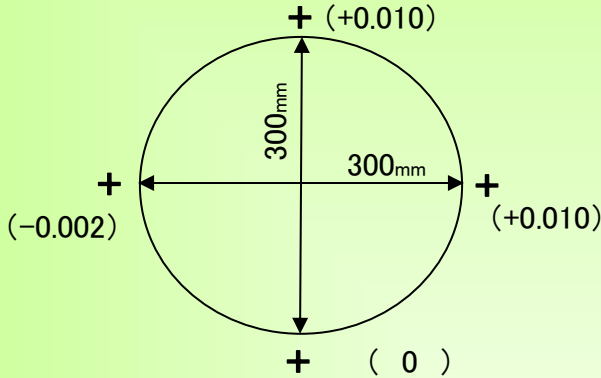

主軸振れ



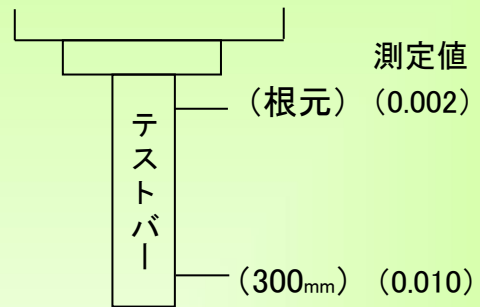


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.010)

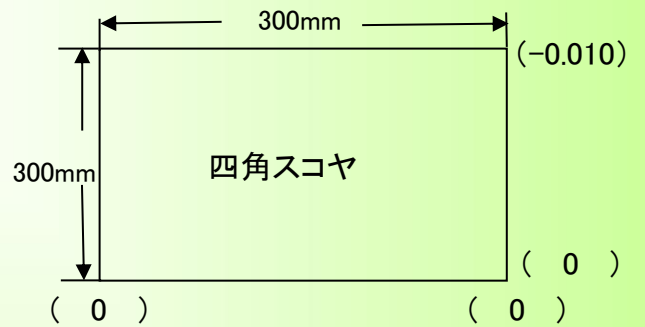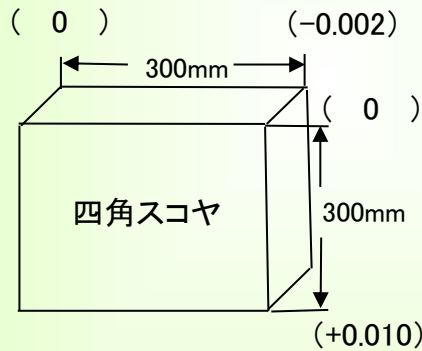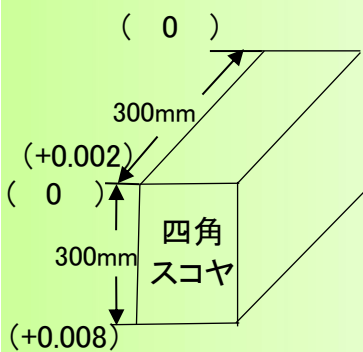

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

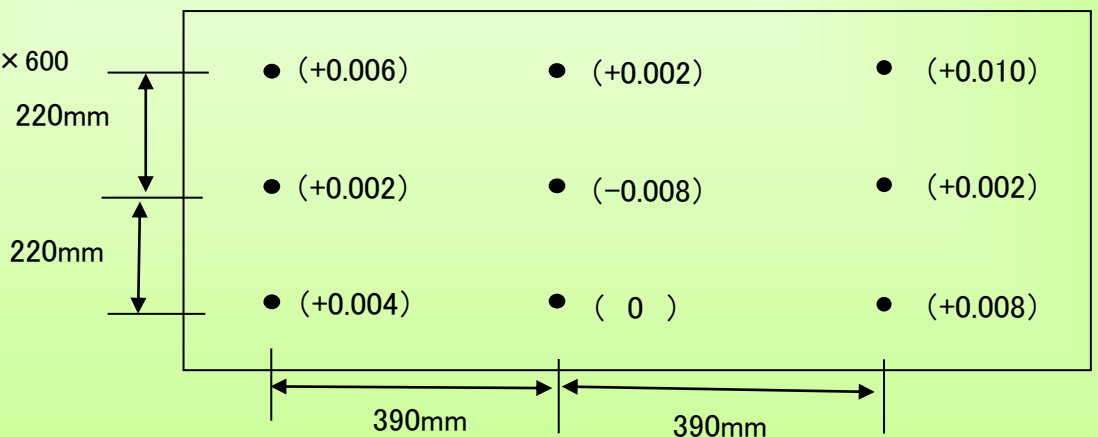

2023/7/28