


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	OKK	年式	2004年製	管理番号	P007984
型式	VP600	測定者	奥澤		

## 振り回し(300ピッチ)

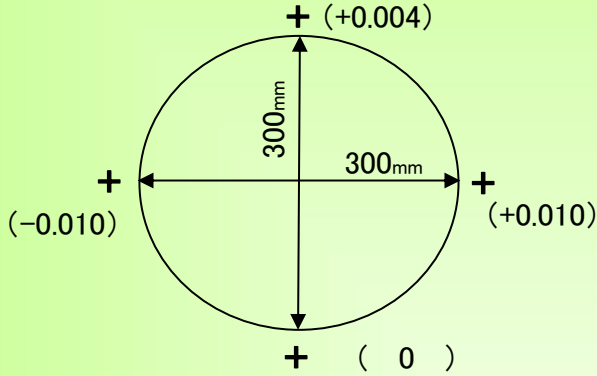

## 主軸振れ



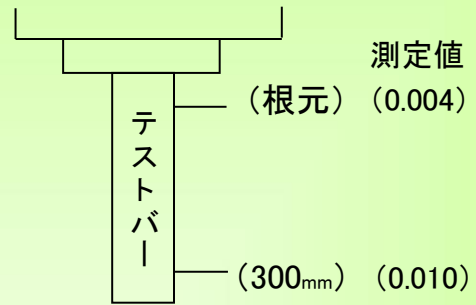


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.018)


【XZ】 測定値 (0.020)

【X Y】 測定値 (0.006)

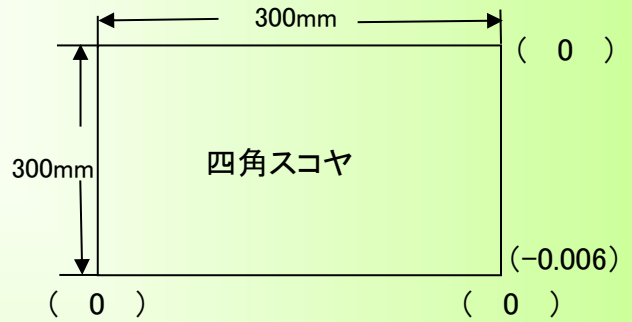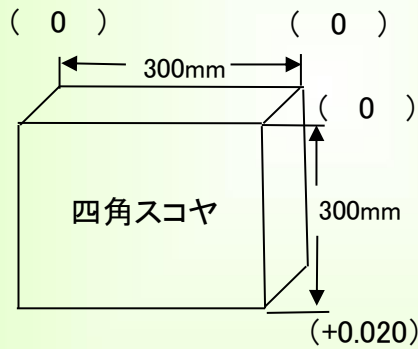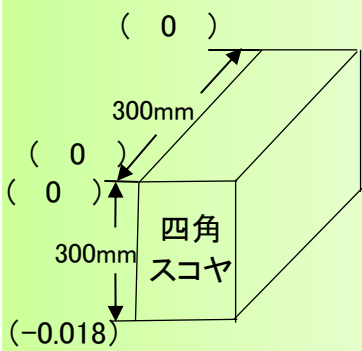

## 上面精度

※テーブルサイズ 610×1300

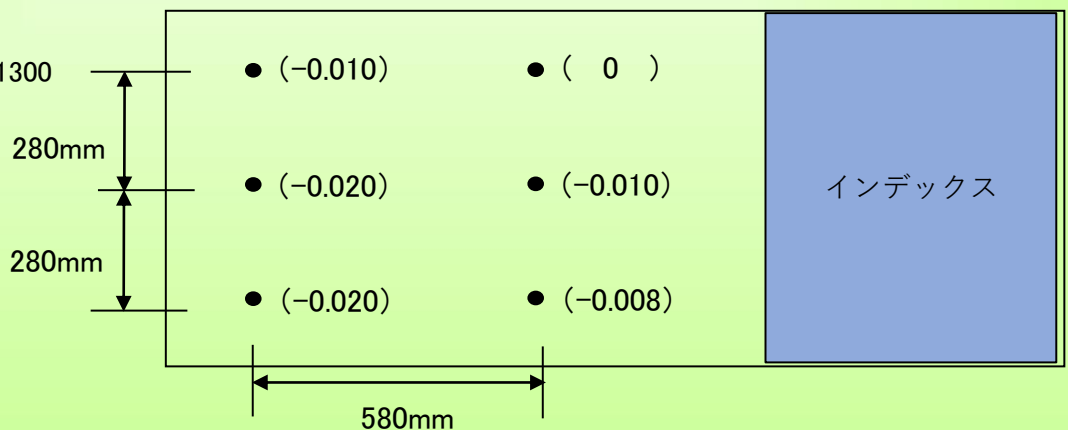

2022/9/29