


# 精度測定検査表


Examination for precision list

|      |            |     |      |        |         |
|------|------------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 森精機        | 年式  | 2011 | 管理番号   | P008464 |
| 型式   | NVX5080/40 | 測定者 | 金子   | アシスタント |         |

## 振り回し(300ピッチ)

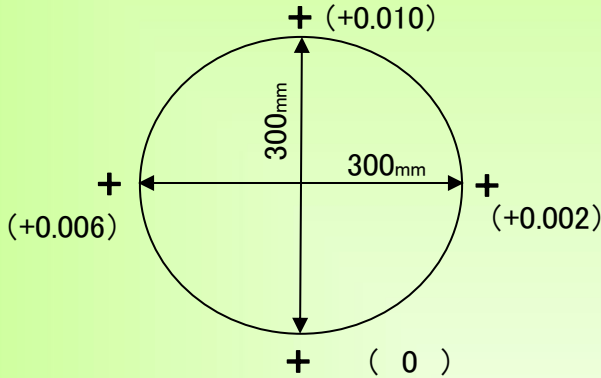

## 主軸振れ



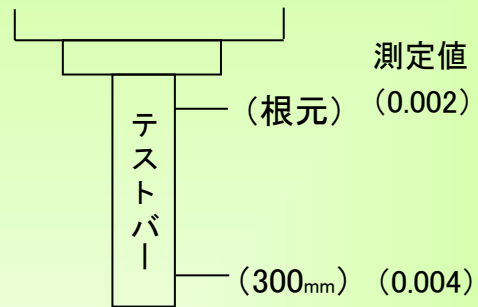


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

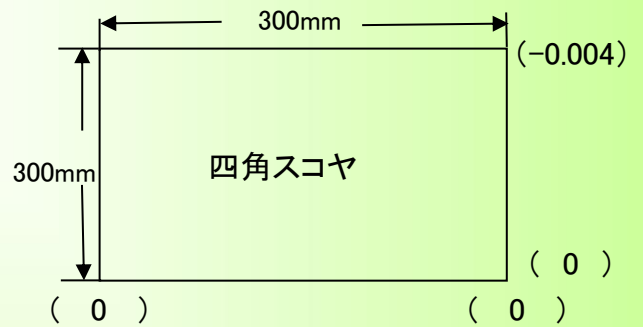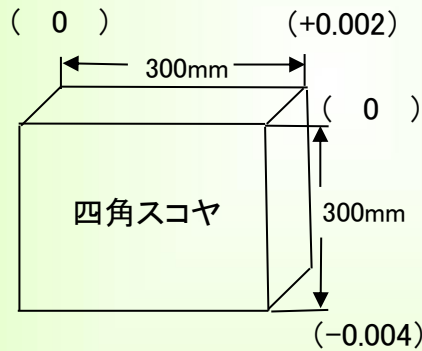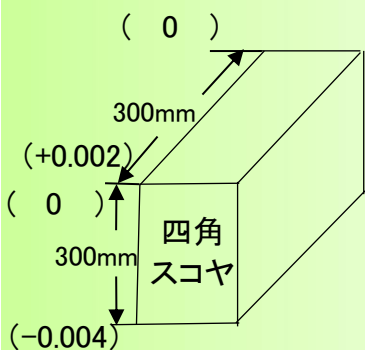

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

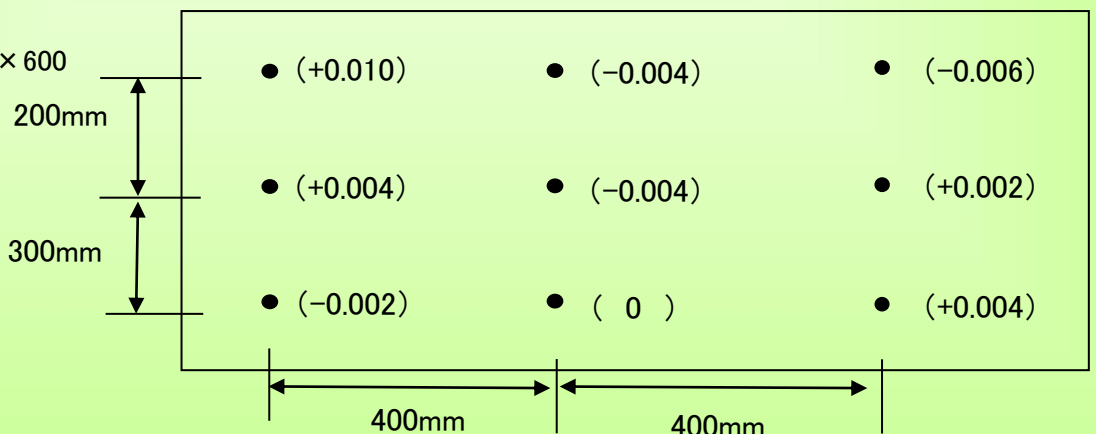

2024/2/2