


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2006年	管理番号	H017391
型式	MILLAC-1052V	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

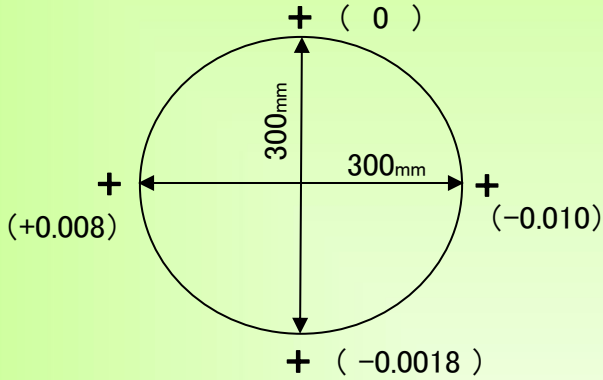

主軸振れ



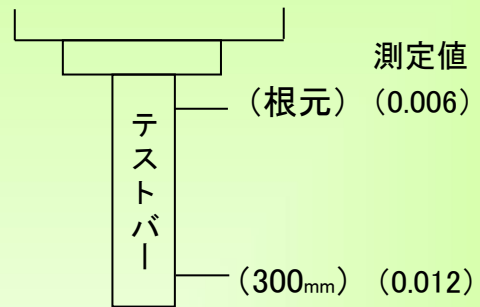


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.012)

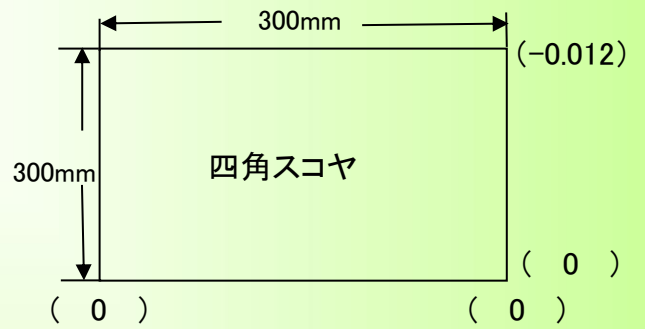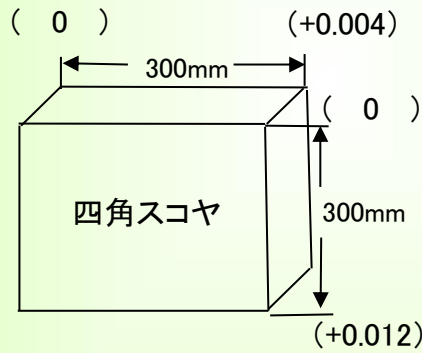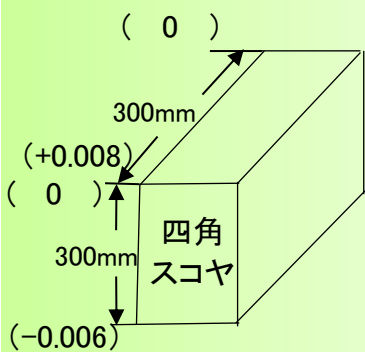

上面精度

※テーブルサイズ 2200×1050

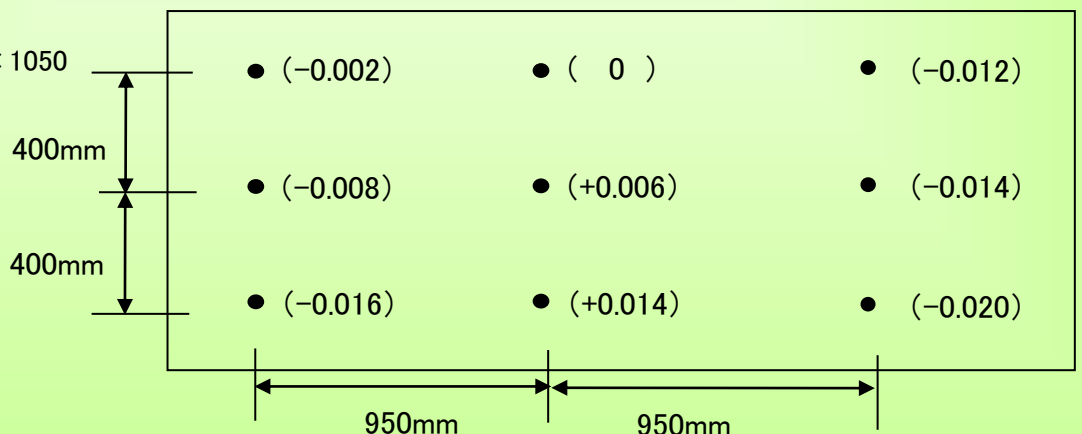

2023/4/12